

ULT25NEU دليل التشغيل السريع

قم بتنزيل كتيب المشغل ودليل التشغيل السريع باللغة التي تختارها من:
www.stirlingultracold.com/manuals



قصه، وغله، واحتفظ به مع المجمد


الإعداد الأولي

١	يجب أن تكون سادة/مانع تسرب المنفذ في مكانها أثناء التشغيل.	سدادة/مانع تسرب المنفذ
٢	تكون الوحدة في وضع التشغيل "ON" عندما تُضيء	مؤشر الطاقة
٣	اضغط مع الاستمرار حتى تسمع صافرتى تنبية	وضع التشغيل "ON"
٤	اضغط مع الاستمرار حتى تسمع ثلاث صافرات تنبية	وضع إيقاف التشغيل "OFF"
٥	تعرض درجة حرارة الغرفة	شاشة عرض LCD
٦	اضغط/حرر لعرض نقطة الضبط الحالية، سيتم عرض S ##	شاشة عرض نقطة الضبط
٧	اضغط/حرر أو انتظر ثانية ثوان	العودة إلى شاشة عرض درجة الحرارة
٨	اضغط مع الاستمرار حتى يُضيء مصباح LED الخاص بضبط درجة الحرارة Set (هـ)، ويتم عرض #S، ثم اضغط على ▲ أو ▼ (دـ)	تغيير نقطة الضبط

وظائف متقدمة

ا	اضغط مع الاستمرار على زر الضبط Set (وـ) حتى يُضيء مصباح LED الخاص بضبط درجة الحرارة Set (هـ)، ويتم عرض S ##، ثم حدد الضبط المسبق Preset 1، 2، أو 3 (يـ)	التغيير إلى الإعداد المسبق
بـ	عندما يُضيء مصباح LED الخاص بدرجة الحرارة المرتفعة "Over Temp" (طـ)، اضغط على الضبط المسبق 3 (يـ) حتى يظهر الوقت 1,0 (ساعة) (إذا لم يُضيء مصباح LED الخاص بدرجة الحرارة المرتفعة Over Temp، فعندئذ يعمل الضبط المسبق 3 باعتباره ضبطاً مسبقاً لدرجة الحرارة)	تأ吉ل إنذار درجة الحرارة المرتفعة
جـ	انتظر ثانية ثوان، واضغط على الضبط المسبق Preset 3 للعودة إلى شاشة عرض درجة الحرارة	العودة إلى شاشة عرض درجة الحرارة
دـ	إذا كان مصباح LED الخاص بالخطأ (Error) (حـ) يُضيء، فاضغط على الضبط المسبق 2 Preset 2 (يـ) لفترة وجيزة (إذا كان مصباح LED الخاص بالخطأ (Error) غير مُضيء، فسيصبح الضبط المسبق 2 هو الضبط المسبق لدرجة الحرارة)	انظر رمز الخطأ مرة أخرى
هـ	اضغط مع الاستمرار على الضبط المسبق 1، 2، و 3 (يـ) حتى يُضيء مصباح Locked (مغلق) (زـ) (حوالي خمس ثوان)	لوحة القفل
زـ	اضغط مع الاستمرار على الضبط المسبق 1، 2، و 3 (يـ) حتى يتطفىء مصباح Locked (المغلق) (زـ) (حوالي خمس ثوان)	لوحة الفتح
ـ	P ## - الضبط المسبق لدرجة الحرارة، # h - تم كتم صوت الإنذار، E ## - رمز الخطأ (انظر دليل التشغيل)	رموز شاشة العرض LCD

- عند تشغيل الوحدة للمرة الأولى، سيُضيء مصباح T (درجة Over Temp) باللون الأحمر حتى تصبح درجة الحرارة في حدود 10 درجات من نقطة الضبط.
- يعتبر قفل اللوحة حتى تصبح درجة الحرارة في حدود 10 درجات من نقطة الضبط.

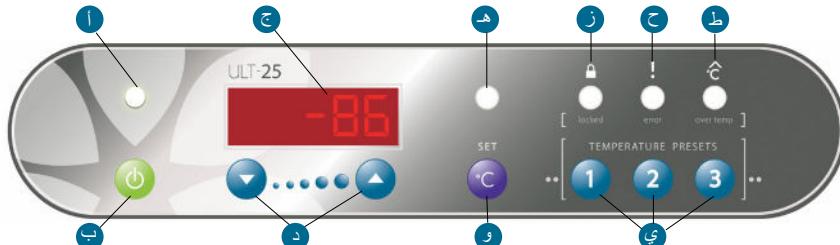

STIRLING
ULTRACOLD

BioLifeSolutions.com 740.274.7901 855.274.7900 / 740.274.7900 الفاكس: الهاتف: 45701, Athens Poston Road 6000

حقوق الطبع والنشر © لعام 2023 لشركة Stirling Ultracold, a part of BioLife Solutions. جميع الحقوق محفوظة.
تصنّع تقنية التبريد العالمي Global Cooling بموجب براءات الاختراع الأمريكية والدولية.
تمتد علامة تجارية خاصة شركة Global Cooling, Inc.
تحضع المواصفات للتغيير دون إشعار. وللاطلاع على أحدث المواصفات، يرجى الرجوع إلى BioLifeSolutions.com.

